



Mano MC ProPlus

Guida per l'utente

Fillauer[®]
Motion Control

Mano MC ProPlus


Guida per l'utente

Introduzione

La mano Motion Control (MC) ProPlus è una mano elettrica ad alte prestazioni per persone con perdita degli arti superiori. La mano MC è disponibile in tre dimensioni e diverse lunghezze per adattarsi a una varietà di individui. Consta di un circuito a risparmio energetico per una maggiore durata della batteria, di dita ad ampia apertura, di telaio e dita lavorati per impieghi gravosi e di un esclusivo rilascio di sicurezza. Ciò si traduce in un dispositivo terminale robusto, efficiente e ad alta velocità per una protesi dell'arto superiore.

La mano MC ProPlus è dotata di un motore CC senza spazzole di lunghissima durata e di un controller integrato. Questo versatile microprocessore offre una facile regolazione tramite la comunicazione wireless Bluetooth® con dispositivi iOS (iPhone®, iPad® e iPod Touch®), un'ampia gamma di sensori di input e prestazioni elevate. La mano MC ProPlus è facilmente intercambiabile con altri componenti MC ProPlus, come l'MC ProPlus ETD, e dispositivi di altri produttori.

Mano MC ProPlus (sezione)

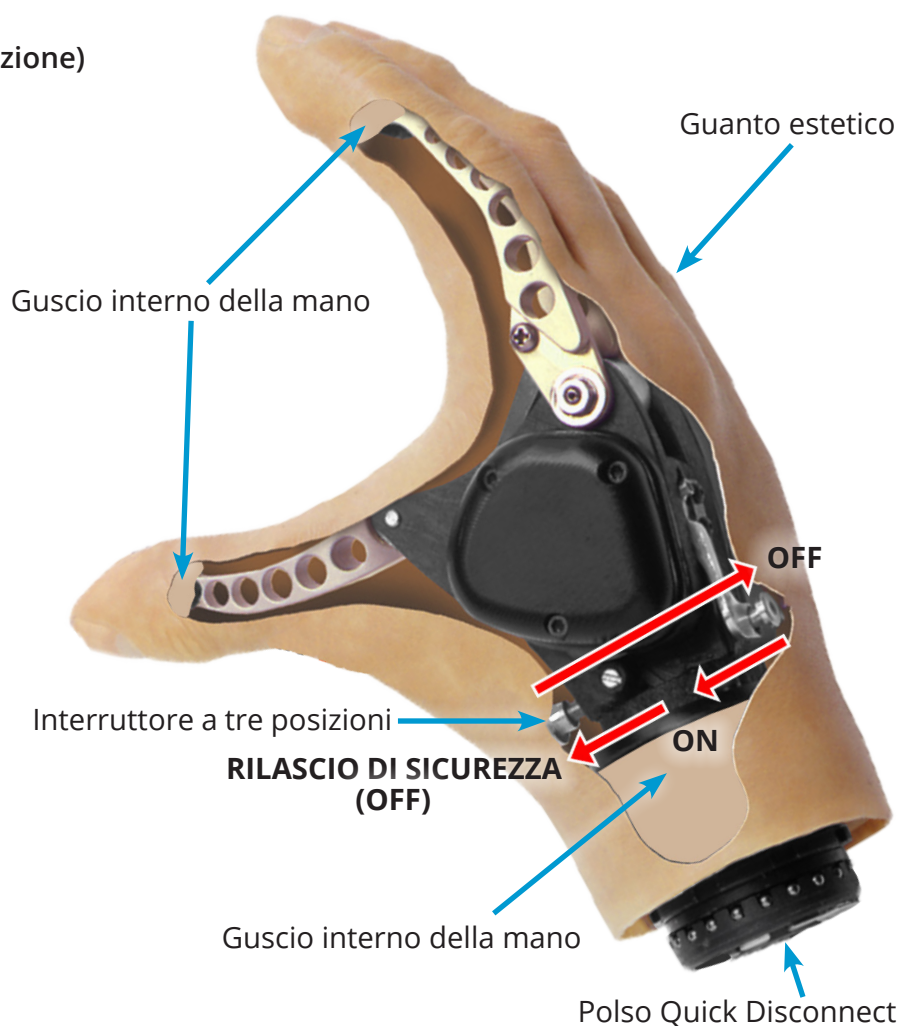

Precauzioni speciali



Gestione del rischio

Per ridurre al minimo il rischio di danni al dispositivo o lesioni all'utente e al contempo usufruire appieno delle funzioni del dispositivo, attenersi alle istruzioni per l'installazione e utilizzare questo dispositivo come descritto nel presente manuale.



La MC Hand è resistente all'acqua, non impermeabile.

Sebbene la Motion Control Hand sia resistente all'acqua, il polso a sgancio rapido non lo è. Non immergere la MC Hand oltre il polso.



Gas infiammabili

Prestare attenzione quando si aziona la mano in prossimità di gas infiammabili. La mano utilizza un motore elettrico che può fungere da innesco per gas volatili.



Non piegare le punte delle dita

Sebbene la mano MC sia robusta, il peso del corpo rappresenta una notevole forza. Non applicare tutto il peso del corpo sulle punte delle dita. Inoltre, una caduta con la forza diretta sulla punta delle dita potrebbe causare danni. Se le punte delle dita appaiono piegate o non allineate, rivolgersi al protesista.



Rilascio di sicurezza

Non forzare l'apertura o la chiusura delle dita. Ciò provocherà gravi danni al dispositivo. Il rilascio di sicurezza consentirà una facile apertura e chiusura della mano. Se il meccanismo di rilascio non consente il movimento, il dispositivo richiede l'assistenza di Motion Control.



Riparazioni o modifiche

Non tentare di riparare o modificare alcuno dei componenti meccanici o elettronici della mano MC. Ciò potrebbe causare danni, richiedere riparazioni aggiuntive e invalidare la garanzia.



Configurazione tramite l'interfaccia utente

Sebbene le impostazioni predefinite della mano MC ProPlus possano consentire al paziente di utilizzare il sistema, si consiglia vivamente al protesista di ricorrere all'interfaccia utente per personalizzare le impostazioni per l'utilizzatore.



Precauzioni di sicurezza

Prestare attenzione quando si utilizza questo dispositivo in situazioni in cui possono verificarsi lesioni per se stessi o per altri, tra cui attività come guidare, azionare macchinari pesanti o qualsiasi attività in cui possono verificarsi lesioni. Condizioni quali batteria quasi scarica o completamente scarica, perdita di contatto dell'elettrodo o malfunzionamento meccanico/elettrico (e altro) possono far sì che il dispositivo funzioni in modo diverso dal previsto.




Incidenti gravi

Nell'improbabile evenienza che si verifichi un incidente grave correlato all'uso del dispositivo, l'utente deve rivolgersi immediatamente a un medico e contattare quanto prima il proprio protesista, l'autorità locale competente e Fillauer. In caso di malfunzionamento del dispositivo, in qualsiasi momento il medico deve contattare immediatamente il rappresentante Fillauer locale e l'autorità locale competente.

Interruttore a tre posizioni

La mano MC è dotata di un interruttore a scorrimento a tre posizioni, situato nella zona centrale del dorso. Verso il lato del palmo, si trova alla base del pollice. Con l'interruttore premuto completamente verso il dorso della mano, la mano è spenta (OFF). Spingendolo dal dorso della mano verso il palmo, con il primo clic si accende la mano (ON). Spingendolo completamente verso il palmo si raggiunge la posizione di RILASCIO DI SICUREZZA, con il rilascio delle dita. Nella posizione di rilascio di sicurezza, la mano viene anche spenta.

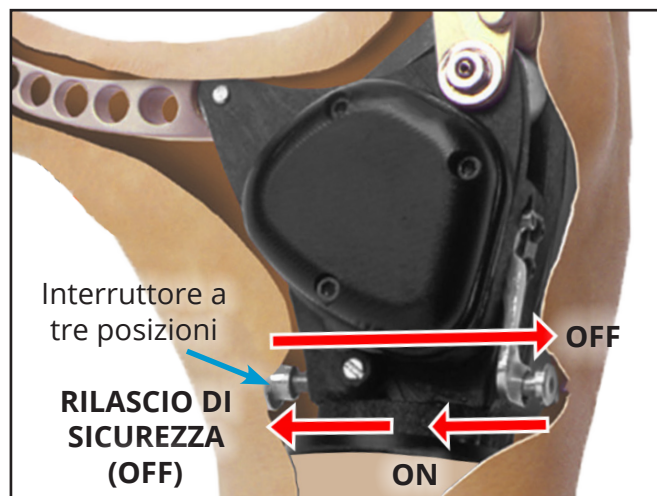

La mano MC ProPlus con l'interruttore a tre posizioni

Polso Quick Disconnect

Il polso Quick Disconnect ha un design universale che consente l'intercambiabilità con i nostri altri dispositivi terminali, come l'MC ProPlus ETD, e i dispositivi di altri produttori.

Guscio interno della mano

Questo guanto resistente viene installato in fabbrica e non deve essere rimosso se non da personale qualificato. Questo guscio offre protezione alla mano e una certa resistenza all'umidità. Se si riscontra un foro o un danno, il guanto interno deve essere sostituito. Alcuni modelli di mani di dimensioni più piccole non hanno un guanto interno, ma sono progettati solo per un guanto estetico.

Guanto estetico

È necessario scegliere un guanto cosmetico che si abbinii il più possibile al tono della pelle dell'utilizzatore. Idealmente, questa scelta dovrebbe essere fatta all'aperto, alla luce naturale, non sotto luci fluorescenti. Consigliamo i guanti Natural Definition per mani Myo disponibili da Fillauer. Mantenere il guanto integro e in buone condizioni. Fori o usura eccessiva potrebbero consentire ai liquidi di penetrare nella mano e causare danni.

Istruzioni per l'uso

Prima di applicare la mano MC all'avambraccio, individuare l'interruttore sul lato palmare alla base del pollice. Assicurarsi che sia spinto completamente verso il dorso della mano (posizione OFF).

Inserire il polso a sgancio rapido della mano nel polso sull'avambraccio. Premendolo saldamente, ruotare la mano fino ad avvertire uno scatto. Si consiglia di ruotare la mano in entrambe le direzioni facendole compiere diversi scatti, quindi tentare di rimuoverla per assicurarsi che sia fissata saldamente.

Ora, spingere l'interruttore sul dorso della mano verso la superficie palmare nella seconda posizione (centrale): la mano è ora accesa e pronta per l'uso.

Per sganciare la mano, prima spegnerla (spingendo l'interruttore fino in fondo verso il dorso della mano), quindi ruotarla in una direzione o nell'altra fino ad avvertire uno scatto leggermente più intenso, al superamento del quale si sgancerà la mano dall'avambraccio. Ciò consente l'intercambiabilità con un altro dispositivo terminale, come l'MC ProPlus ETD.

Danni da acqua

La mano Motion Control non è impermeabile. In caso di penetrazione nella mano di acqua o altro liquido, rimuovere la mano agendo sullo sgancio rapido (o spegnerla se non è presente lo sgancio rapido). Se la mano è solo leggermente bagnata (non è stata immersa in acqua), asciugarla il più possibile prima di tentare di accenderla e azionarla. Se non funziona, o se la mano è stata immersa, rivolgersi al protesista.

Regolazioni dell'interfaccia utente

Ciascuno dei prodotti della famiglia ProPlus di Motion Control contiene un microprocessore che può essere regolato e impostato per le esigenze di un individuo specifico. Possono essere accettati anche utilizzatori senza segnali EMG, ma in questo caso potrebbe rendersi necessario l'impiego di hardware aggiuntivo. Il software necessario per effettuare queste regolazioni viene fornito gratuitamente al protesista o all'utente finale.

Interfaccia utente iOS

La mano MC ProPlus ha subito un aggiornamento fondamentale a metà del 2025. I dispositivi acquistati prima di tale data utilizzano l'app Motion Control User Interface (MCUI) per la configurazione. I modelli acquistati successivamente richiederanno l'uso della Motion Arm User Interface (MAUI) per la configurazione iniziale. Entrambe le applicazioni sono disponibili gratuitamente sull'Apple Store; i dispositivi Android non sono supportati. Si prega di fare riferimento al proprio dispositivo specifico e alle Guide rapide alla configurazione riportate al termine del manuale.

***Nota:** l'app MCUI/MAUI *non* è disponibile per i dispositivi Android.

Controlli paziente/protesista


All'apertura dell'applicazione iOS, verrà presentata la scelta fra "Patient" [Paziente] e "Prosthetist" [Protesista]. Selezionare "Patient" [Paziente]. Sebbene il paziente possa navigare nell'intera applicazione, molte delle regolazioni sono disabilitate poiché possono essere modificate solo dal protesista.

È comunque possibile vedere la forza dei segnali (o altri input) in modo da poter esercitare i muscoli corrispondenti.

Inoltre, è possibile modificare qualsiasi regolazione che non sia disabilitata, tra cui i cicalini e molte delle regolazioni della funzione opzionale FLAG.

Profili utente

L'utente può salvare il proprio profilo nella sezione User Profile [Profilo utente] dell'interfaccia utente iOS. È consigliabile salvare il profilo sul proprio dispositivo; anche al protesista viene consigliato di farlo, in modo da poter disporre di un backup nel caso in cui siano necessari riparazioni o aggiornamenti del firmware.

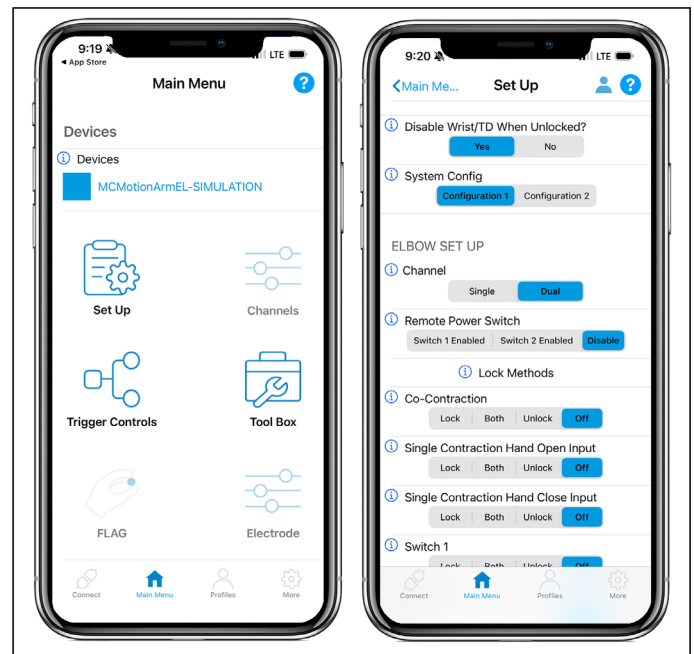

Menu principale e schermate di configurazione di MAUI. L'app Motion Control UI è disponibile sull'Apple Store.

FLAG (opzionale)

FLAG (Force Limiting, Auto Grasp [Limitazione della forza, presa automatica]) è una funzionalità opzionale della mano MC ProPlus e dei dispositivi terminali ETD. FLAG fornisce due funzioni:

- **Force Limiting [Limitazione della forza]**, per evitare lo schiacciamento di oggetti a causa di un'eccessiva forza di strizione
- **Auto Grasp [Presa automatica]**, che aumenta leggermente la presa su un oggetto se viene rilevato un segnale di apertura involontario dal controller

Attivazione/disattivazione della funzione FLAG

All'accensione, la funzione FLAG è disattivata. Prima di utilizzare FLAG occorre chiudere e poi riaprire il dispositivo terminale. Per attivare la funzione FLAG, trasmettere al dispositivo il segnale "Hold Open" [Tieni aperto] (per ~3 s)**. Quando la funzione FLAG viene attivata, l'utilizzatore avvertirà una vibrazione prolungata. Un segnale "Hold Open" [Tieni aperto] (per ~3 s)** disattiverà la funzione FLAG e l'utilizzatore avvertirà due brevi vibrazioni.

Nota: una serie di **5 vibrazioni** percepite al segnale "Hold Open" [Tieni aperto] potrebbe indicare un malfunzionamento del sensore FLAG. Spegner e riaccendere il dispositivo, quindi aprirlo e richiuderlo completamente. Riprovare a inviare il segnale "Hold Open" [Tieni aperto] per attivare la funzione FLAG. Se si avvertono nuovamente 5 vibrazioni, il dispositivo continuerà a funzionare ma la funzione FLAG verrà disabilitata. Restituire il dispositivo a Motion Control per la riparazione del sensore FLAG.

FLAG a doppio canale

Force Limiting [Limitazione della forza]

1. Con la funzione FLAG attivata, la chiusura è sempre proporzionale, con la velocità massima ridotta del 50%**.
2. Alla chiusura, quando le dita toccano un oggetto, la forza sarà limitata a ~1 kg/9 N (2 lb/9 N) di forza di presa, quindi l'utilizzatore avverte una breve vibrazione.
3. Per aumentare la forza, l'utilizzatore rilassa fino a scendere al di sotto della soglia, quindi invia un forte segnale di chiusura** per un breve sforzo** e la forza di presa aumenta di un "impulso".
4. La forza di presa può aumentare per 10 volte fino a un massimo di ~8 kg/80 N (18 lb/80 N) di forza di strizione**.
5. Un segnale di apertura aprirà proporzionalmente il dispositivo terminale.

Auto Grasp [Presa automatica]

Con la funzione FLAG attivata, un segnale di apertura rapido e involontario risulterà in un singolo "impulso" di aumento della forza di presa per evitare la caduta di un oggetto.**

FLAG a canale singolo

Con Single Channel Control [Controllo a canale singolo], la funzione FLAG viene utilizzata al meglio in Alternating Direction Control Mode [Modalità di controllo della direzione alternata].

Force Limiting [Limitazione della forza]

1. Con la funzione FLAG attiva, il terminale si chiuderà a circa il 50% della velocità**, proporzionalmente.
2. Quando il dispositivo tocca un oggetto, la forza sarà limitata a ~1 kg/9 N (2 lb/9 N).
3. Un segnale rapido e forte** al di sopra della soglia, quindi un rilassamento al di sotto della soglia, creerà un impulso nella forza**.
4. Ciò può essere ripetuto fino a 10 volte per raggiungere una forza di strizione di ~8 kg/80 N (18 lb/80 N).
5. Un segnale continuo di circa 1 secondo causerà l'apertura del dispositivo terminale.

Auto Grasp [Presa automatica]

Con la funzione FLAG attiva, qualsiasi segnale rapido e involontario provocherà la chiusura del dispositivo terminale, impedendo la caduta dell'oggetto.

Utilizzo di FLAG con input alternativi (inclusi touch pad, potenziometro lineare o sensore di forza)

Nell'interfaccia utente, impostare Control Type [Tipo di controllo] su Alternate Input [Input alternativo] e scegliere Single Channel [Canale singolo] o Double Channel [Canale doppio]. Le impostazioni di Gain [Guadagno] devono essere stabilite in modo che il segnale di output dell'utilizzatore sia sufficientemente alto da superare il valore di Hold Open Threshold [Soglia di tenuta in apertura]** necessario per attivare o disattivare la funzione FLAG.

****Nota:** queste impostazioni sono regolabili nell'applicazione MCUI/MAUI iOS

2-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Hold Open 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Turn Off	Hold Open 2-3 seconds	Double Buzz

1-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Signal 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Quick Signal ± 1 second	Short Buzz
Open	Strong Signal 2-3 sec.	None, direction will reverse as usual
Turn Off	Open the hand then Signal 2-3 seconds	Double Buzz

Interfaccia utente MCUI per iOS

Guida rapida alla configurazione

Configurazione rapida dell'interfaccia utente di Motion Control per Apple® iOS (MCUI [Motion Control User Interface])

1. Dall'Apple® App Store  scaricare e installare l'interfaccia utente MCUI. 
2. Selezionare "Paziente" quando richiesto. I pazienti non necessitano di un codice.
3. Aprire l'app e seguire le istruzioni del tutorial.
4. Andare alla schermata Connect [Connetti]  e toccare Scan [Scansione]. 
5. Immettere il valore Pairing Key [Chiave di associazione].
6. Il dispositivo è ora connesso all'interfaccia MCUI.
7. Per disconnettersi, toccare l'icona Connect [Connetti] nell'angolo in basso a sinistra,  quindi toccare Disconnect [Disconnetti]. 

Requisiti di sistema

Account Apple® App Store e uno dei seguenti dispositivi:

- iPad, iPhone o iPod Touch con iOS 11 o versioni successive.

Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia completamente carica
- Verificare la connessione del dispositivo nel polso a sgancio rapido
- Verificare che il dispositivo sia acceso
- Verificare di non essere in "Tutorial Mode" [Modalità tutorial] toccando due volte il tasto Home, quindi facendo scorrere l'interfaccia MCUI fuori dallo schermo e riaprendola
- Il Bluetooth® deve essere attivato in Settings [Impostazioni]  sul dispositivo iOS
- L'icona Information [Informazioni]  fornisce informazioni su una funzione
- Per ripetere il tutorial, andare a  e toccare **Riavvia** in Reset Guided Tutorial [Riavvia tutorial guidato]

* Per la configurazione dei dispositivi prima della metà del 2025. Fare riferimento al proprio dispositivo specifico. Anche la funzione AutoCal è stata disattivata. Contattare il servizio clienti in caso di necessità.

App MAUI per iOS

Guida rapida alla configurazione



Configurazione rapida dell'interfaccia utente di Motion Arm per Apple® iOS (MAUI)

- Scaricare l'app MAUI  dall'App Store Apple®. 
- Selezionare "Paziente" quando richiesto. I pazienti non necessitano di un codice.
- Aprire l'app e guardare il tutorial.
- Andare alla schermata Connettere  e toccare Scansione. 
- Inserire la chiave di accoppiamento fornita con il dispositivo.
- A questo punto, il dispositivo è collegato all'interfaccia utente Motion Arm (MAUI).
- Per disconnettersi, toccare l'icona Connettere nell'angolo in basso a sinistra  e poi Disconnettere. 

Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia completamente carica
- Verificare che il dispositivo sia acceso
- Verificare di non essere in modalità di simulazione toccando due volte il tasto Home. Dopodiché, chiudere l'app MAUI facendola scorrere fuori dallo schermo e poi riapirla
- Il Bluetooth® deve essere attivato dalle impostazioni  del dispositivo iOS
- L'icona "Informazioni"  fornisce dettagli su una determinata funzione
- Per riguardare il tutorial, andare su  e toccare **Reset** Ripristinare tutorial guidato

Requisiti di sistema

- iPad, iPhone o iPod Touch con iOS 11 o versioni successive.



Download the
MAUI software on
the Apple Store.

* Per la configurazione dei dispositivi rilasciati dopo la metà del 2025. Fare riferimento al proprio dispositivo specifico. Anche la funzione AutoCal è stata disattivata. Contattare il servizio clienti in caso di necessità.

Uso per singolo paziente

Ogni amputato è unico. La forma del moncone, i segnali di controllo che ciascuno genera e le attività che un amputato svolge durante la giornata richiedono una particolare progettazione e un adattamento della protesi. I prodotti Motion Control sono realizzati per adattarsi a un particolare individuo.

Smaltimento/gestione dei rifiuti

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità con le leggi e le normative locali vigenti. Ciò include le leggi e le normative relative ad agenti batterici o infettivi, ove necessario.

Garanzia limitata

Il Venditore garantisce all'Acquirente che l'attrezzatura consegnata ai sensi del presente accordo sarà priva di difetti di materiale e di fabbricazione, che sarà del tipo e della qualità descritti e che funzionerà secondo le specifiche indicate nel preventivo scritto del Venditore. Le garanzie limitate si applicheranno esclusivamente alle ipotesi di mancata conformità a quanto sopra garantito che si manifestino entro il periodo di validità del presente Accordo. Il periodo di validità è di due anni (24 mesi*) a decorrere dalla data di consegna al centro di installazione che ha acquistato i componenti. Per la data di spedizione, fare riferimento alla relativa ricevuta. *Il periodo di 24 mesi si applica ai dispositivi acquistati successivamente al 1° gennaio 2026.

Politica di reso

I resi sono accettati per un rimborso completo entro 90 giorni dalla data di spedizione, a condizione che l'articolo sia in condizioni rivendibili. Oltre i 90 giorni, i resi non vengono accettati.

Specifiche tecniche

Temperatura di esercizio: da -5°C a 60°C (da 23°F a 140°F)

Temperatura di trasporto e conservazione: da -18°C a 71°C (da 0°F a 160°F)

Forza di strizione: a 7,2 volt nominali: 10 kg (22 lb o ~100 N)

Intervallo di tensione di esercizio: da 6 a 8,2 Vdc - mano MC ProPlus

Limite di carico: 22 kg / 50 lb in tutte le direzioni (+/-10%)

Vita utile del dispositivo: 5 anni

Dichiarazione di conformità

Il presente prodotto è conforme al regolamento sui dispositivi medici 2017/745 ed è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti (Registrazione n° 1723997).



Customer Support

Americas, Oceania, Japan

Fillauer Motion Control

115 N. Wright Brothers Drive
Salt Lake City, UT 84116
+1 801-326-3434
motioninfo@fillauer.com

Europe, Africa, Asia

Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00
support@fillauer.com

Fillauer®

www.fillauer.com



Fillauer

2710 Amnicola Highway
Chattanooga, TN 37406
+1 423.624.0946



Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00

